

# Descripción del producto

# visine®

Canadian visitor technology license

**Strong Sterilization Spray**



**Fog spray is effective all day**





# visine

Widely used in sterilization  
and antibacterial

Negative ion slow-release sterilization technology





24 hours to maintain negative ion "curtain wall"

When flowing air or body droplets  
After falling to the "curtain wall" by  
negative ions Actively capture and  
decompose into harmless points to  
avoid cross-infection of bacteria.




# visine Negative ion slow-release black technology

## Antibacterial rate test report

中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0823



201719001121

检测编号: WJ20180524(R)  
Test No.

**广州工业微生物检测中心**  
GUANGZHOU TESTING CENTER OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY  
**检测报告**  
TEST REPORT

收样日期: 2018年3月6日      检测日期: 2018年3月13日  
Date Received      Date Analyzed

样品名称 Name of Sample	森离子喷剂	样品来源 Source of Sample	送样
委托人 Client	广州市健堂生物科技有限公司	委托人 Client	广州市健堂生物科技有限公司
样品等级 Sample	广州市健堂生物科技有限公司	样品等级 Sample	广州市健堂生物科技有限公司
商标 Brand		商标 Brand	
样品数量 Quantity	828	样品数量 Quantity	
样品包装 Packaging		样品包装 Packaging	
样品用途 Use	抗菌涂料	样品用途 Use	

### 24 hours testing time

### Antibacterial 99.9%

Remarks: 申明: 此款产品还有HSI200/WSI300装与此是同一产品。本报告替代2018年4月10日签发的WJ20180524报告, 原报告作废。

检测结果:  
Test Result

样品编号	作用时间	试验菌种	阴性对照样菌落数(cfu/片)	空白样菌落数(cfu/片)	试验样菌落数(cfu/片)	抗菌率(%)
WJ20180524 (R)-1	24h	大肠杆菌	6.78×10 <sup>7</sup>	9.52×10 <sup>7</sup>	<1000	>99.9
		金黄色葡萄球菌	7.32×10 <sup>7</sup>	1.04×10 <sup>8</sup>	<1000	>99.9


\*\*\*报告结束/End of report\*\*\*

编制: 梁翠芬  
Editor: 梁翠芬

审核: 郑苗  
Checker: 郑苗

签发: [Signature]  
Issuer: [Signature]

签发日期(公章)  
Date Reported: 2018.4.12



无色无味森离子



# visine

International certification  
authority testing

## PK traditional sterilization products



- **Continuous sterilization and antibacterial**  
One mist spray is effective for 24 hours
- **Pure water formula does not hurt your hands**  
Ethanol-free, odorless and non-irritating
- **99.9% bactericidal and antibacterial**  
Broad-spectrum sterilization / antibacterial / odor removal / mildew resistance
- **Easy to carry and use**  
Non-flammable and explosive / safe and reliable



**visine<sup>®</sup>** Black technology PK  
traditional products



Canada visine technology authorization





# visine®

SGS



CNAS



**No alcohol**  
Keeps killing 99.999% of germs



## Strength Anti-microbial Spray

Work Placesse



Staying in Hotel



Using Public Toilet



Take the subway



Using Mask



Shopping



## Especificación

nombre del producto	Aerógrafo de niebla de esterilización fuerte / <b><u>Esterilizador portátil de 10 ml, pluma en aerosol vacía</u></b>
Número de producto	VSI 100 10 ml
Ingredientes del producto	Agua purificada, solución madre de factor antibacteriano de iones negativos, extracto vegetal y agente activo
Pautas de uso	Mata eficazmente las bacterias en la superficie del objeto, reduce la posibilidad de infección cruzada bacteriana y mejora la capacidad antibacteriana. Simplemente rocíe la superficie del objeto, en el aire y en contacto con el objeto

## Embalaje y envío

### Empaquetado y entrega

Unidades de venta	Objeto unico			
Tamaño de paquete único	El 15X2X2cm			
Peso bruto único	00,050 kilogramos			
<b>Tipo de paquete</b>	14 * 1.5 * 1.5 cm / pieza			
	12 uds / caja			
	16 * 5,5 * 9 cm / caja			
	288 piezas / caja			
	24 cajas / ct			
36 * 33 * 16 / caja				
<b>Tiempo de espera</b>				
Cantidad (piezas)	1-100	101-500	501-1000	> 1000
Est. Tiempo (días)	3	5	7 7	Ser negociado




Para garantizar mejor la seguridad de sus productos, se proporcionarán servicios de embalaje profesionales, ecológicos, convenientes y eficientes.

## EmpresaPerfil

A medida que el Coronavirus se extendió por todo el mundo, especialmente durante enero a febrero en China, incluso tuvimos una gran escasez de máscaras y tipos de productos en contra de la situación. Ahora, China está mejorando y es responsabilidad principal ayudar a los amigos del mundo con estos



productos ([fabricante de dispensadores de spray desinfectante](#)), Consulte más sobre nuestro sitio web [Antivirus](#)

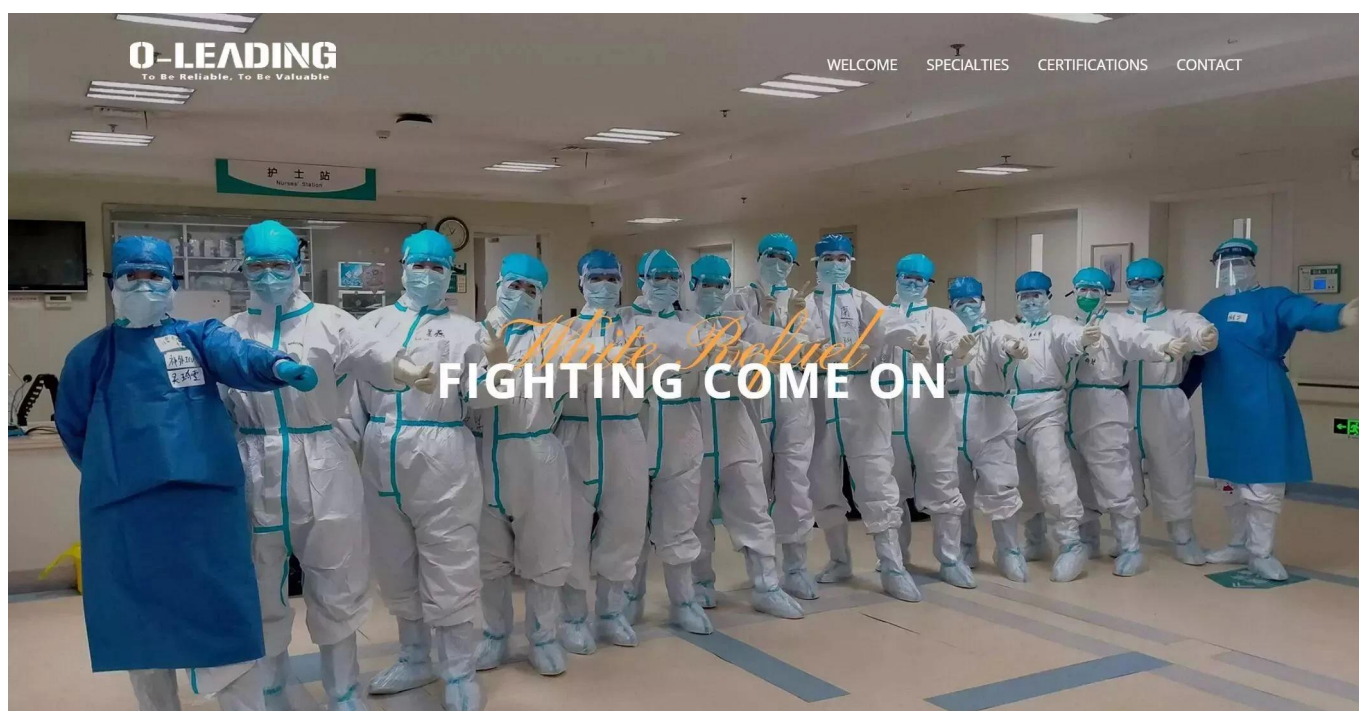

## Preguntas más frecuentes

P: ¿Cómo puedo obtener muestras del dispensador de jabón automático para comprobar su calidad?

R: El pedido de muestra está disponible, se puede enviar por Express, lo recibirá en 3-7 días.

Q: ¿Qué puedo obtener el precio?

R: Por lo general, cotizamos dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de su consulta. Si es muy urgente obtener el precio, infórmenos en su correo electrónico para que consideremos su consulta como una prioridad.

P: ¿Cuál es su plazo comercial de entrega?

A: Aceptamos puerto de destino EXW, FOB Shenzhen o CIF. Puedes elegir el que es el más conveniente o rentable para usted.

P: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega para la producción en masa?

R: Honestamente, depende de la cantidad del pedido y de la temporada en que realice el pedido. El pedido de muestra es de 2 días. Los pedidos de OEM / OEM necesitarán más tiempo.